

Số: 01/TB-TTYT

Hòa Bình, ngày 06 tháng 1 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty, nhà cung cấp trang thiết bị y tế trên toàn quốc

Trung tâm thông báo đến các Công ty có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu tham gia gửi báo trang thiết bị y tế như sau:

1. Danh mục trang thiết bị cần kiểm định:

STT	Trang thiết bị	Đơn vị tính	Giá báo	Ghi chú
1	MÁY THEO DÕI SẢN KHOA Thông số kỹ thuật: Màn hình: Màn hình màu LCD ≥ 8 inch Hiển thị: Biểu đồ nhịp tim và chỉ số tim thai FHR: 120BPM - 160 BPM Báo bất thường FHR: Có Đầu dò: chùm tia rộng Điện áp: 100-240V, 50-60Hz <ul style="list-style-type: none">Đầu dò siêu âm:<ul style="list-style-type: none">- Tần số ≥ 1 MHz- Tần số làm việc: $1 \text{ MHz} \pm 10\%$- Áp suất đỉnh: $P \leq 1 \text{ MPa}$- Cường độ chùm tia đầu ra: $I < 20 \text{ mW/cm}^2$ Bảo hành thiết bị: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Bảo trì, bảo dưỡng: 3 tháng / lần <ul style="list-style-type: none">- Cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong 05 năm sau khi hết hạn bảo hành.- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành,	Cái		

	<p>sửa chữa nhỏ thiết bị tại đơn vị sử dụng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì chi tiết (Tiếng Anh + Tiếng Việt) - Cung cấp CO, CQ 			
2	<p>MÁY TRỊ LIỆU BẰNG SÓNG SIÊU ÂM</p> <p>Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nguồn điện 100 - 240 V / 50 Hz / 60 Hz - Công suất tiêu thụ : Tối đa. 60 VA - Lớp bảo vệ điện: II - Áp dụng: Loại BF, đầu siêu âm - Chế độ hoạt động: Hoạt động liên tục - Phân loại IP: Thiết bị IPX0, đầu siêu âm IPX7 - Hiển thị: màn hình màu cảm ứng - Điều kiện hoạt động: 10 ° C đến + 40 ° C, 30% đến 75% độ ẩm tương đối không ngưng tụ, 800 hPa - 1060 hPa - Vận chuyển / Bảo quản: -10 ° C đến + 50 ° C, độ ẩm tương đối từ 10% đến 90% không ngưng tụ, ở 500 hPa - 1060 hPa <p>Hiệu suất</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tần số: 1 MHz và 3 MHz - Mức độ cường độ: 0,1 đến 3 W/cm² ở khoảng 0,1 W/cm² - Công suất tối đa 6 W eff ở chế độ liên tục, 9 W peak ở chế độ xung - Độ chính xác ± 20% - Đầu siêu âm: 5 cm², AER = 3,0 cm², BN ≤ 5.0 - Thời gian điều trị tối đa: 30 phút - Chế độ siêu âm: <ul style="list-style-type: none"> + Siêu âm liên tục + Siêu âm xung, điều chỉnh tần số xung : 10 Hz, 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz - Bảo hành thiết bị: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. - Bảo trì, bảo dưỡng: 3 tháng/ lần - Cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong 05 năm sau khi hết hạn bảo hành. - Đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành, sửa chữa nhỏ thiết bị tại đơn vị sử dụng. - Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì chi tiết (Tiếng Anh + Tiếng Việt) - Cung cấp CO, CQ 	Cái		

2. **Thời gian nhận báo giá** : Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/1/2024.

3. **Đơn vị yêu cầu báo giá**: Trung tâm Y tế huyện Hòa Bình tỉnh Bạc Liêu.


Quý Công ty, nhà cung cấp gửi báo giá trực tiếp về Khoa Dược-TTB-VTTYT – Trung tâm Y tế huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu tại *địa chỉ*: số 654, quốc lộ 1A, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu và *file mềm gửi về địa chỉ email*: ngatri2806@gmail.com *trước* 17 giờ, ngày 10/1/2024.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Khoa Dược-TTB-VTTYT Trung tâm Y tế huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu tại *địa chỉ*: số 654, quốc lộ 1A, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. *Số điện thoại*: 0918.777.880

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các công ty báo giá;
- Lưu: VT.

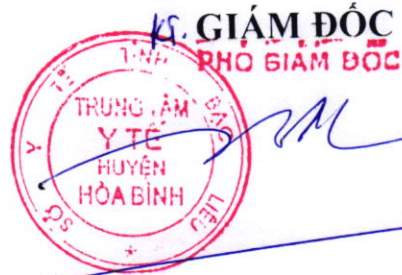

Cao Trúc Nha